


Protección teléfonos móviles Neutralizer

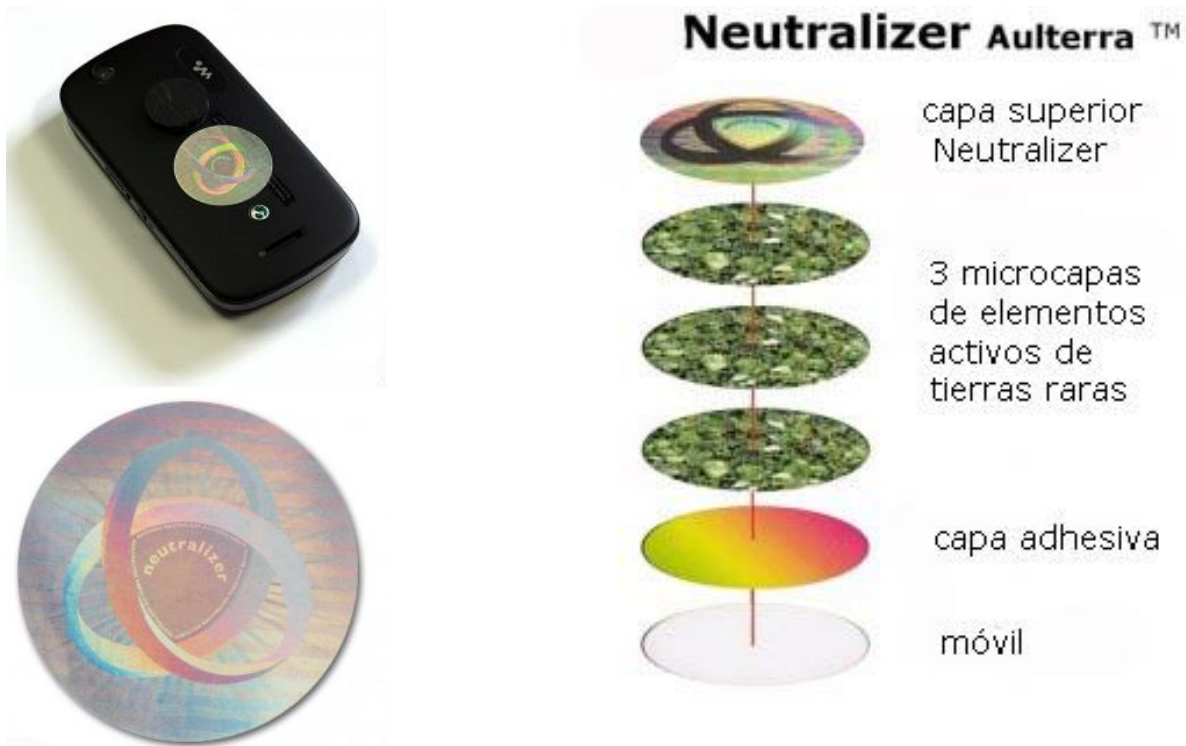

Neutralizer es una pastilla adhesiva de 3 cm de diámetro que se adhiere en los teléfonos móviles, o en los aparatos que emiten ondas wifi o radiofrecuencias. El Neutralizer está compuesto de polvo de rocas sedimentarias en el que se encuentran sílice, hierro y titanio, así como concentraciones relativamente elevadas de tierras raras altamente paramagnéticas como el cerio o el lantano. El polvo obtenido de la mezcla de los diferentes metales es reducido a finas partículas y activado según un método patentado de naturaleza homeopática (patente de USA 60/820205). El producto final denominado Neutralizer™ se compone de 3 capas de vinilo de 0,1mm de espesor y de 3 cm de diámetro, recubiertas de la mezcla mineral activada utilizando como portador tinta de imprenta.

El Neutralizer™ es uno de los pocos productos en el mercado avalado por estudios in vitro que demuestran que protege el ADN humano de los efectos dañinos de los campos electromagnéticos y las radiofrecuencias. El Neutralizer no interfiere con el funcionamiento del teléfono móvil.


Contrariamente a otros dispositivos de protección de los campos electromagnéticos no afecta a la recepción ni a la transmisión del teléfono móvil. El teléfono funcionará normalmente, pero no será una amenaza ni para el ADN ni para la salud.

EL Neutralizer también resulta efectivo con otros equipos que generan radiaciones electromagnéticas: ordenadores, teléfonos inalámbricos, televisión, consolas de juego, hornos microondas...


El doctor Glein Rein investigador del laboratorio de investigación en biología cuántica de Nueva York ha validado en el año 2000 un estudio en el que concluye:

“La energía coherente natural que emana el Neutralizer™ ha atenuado la energía incoherente que emiten los campos electromagnéticos artificiales, volviéndolos inofensivos para el ADN humano”

sin Neutralizer

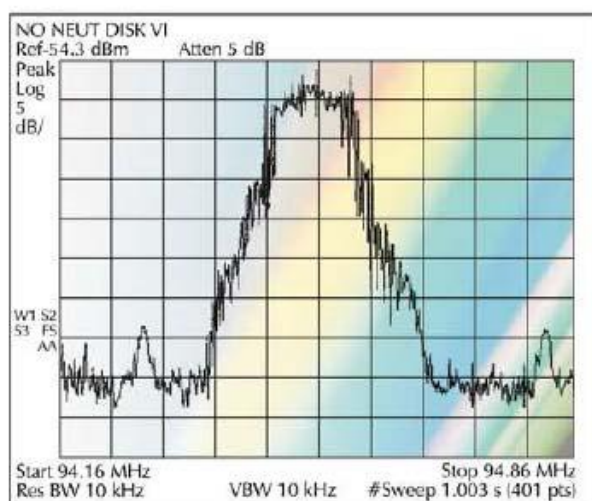

con Neutralizer

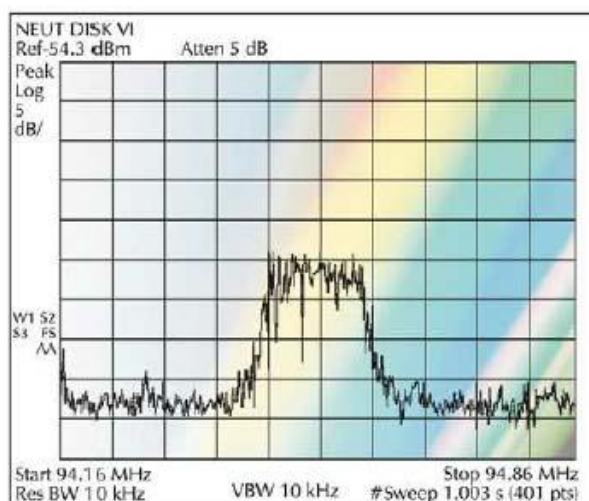

Según este estudio in vitro los cambios en la conformación del ADN inducidos por las radiaciones del teléfono celular se redujeron en un 95% cuando el teléfono tenía adherida la tarjeta Neutralizer. La conclusión del estudio muestra que el Neutralizer reduce las radiaciones e impide los efectos de las radiaciones del teléfono celular en el ADN in vitro.

El Neutralizer es eficaz contra todo tipo de radiaciones nocivas: bajas frecuencias, hiper frecuencias, wifi, GSM...

El Neutralizer funciona con todo tipo de teléfonos móviles: cualquier tipo de antena, cualquier marca y modelo, tanto antiguos modelos como nuevos.

Las mediciones físicas se realizaron en el laboratorio americano:

Quantum Biology Research

670 Carl's Path

Deer Park, N.Y. 11729

Investigaciones completadas en 2000, 2002, 2006, 2007.

Extracto del informe del test biológico realizado por Maria Syldona, Ph.D. :

“Reducción in-vitro del efecto de los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles en el ADN humano y la intensidad de la radiación emitida”

Quantum Biology Research Lab, PO Box 428, Ridgway, CO. 81432

quantumbio@ouraynet.com and

Formerly Assistant Professor at Dept. of Psychiatry, State University of NY at Stony Brook, Medical School.

(Recibido el 8 de Abril de 2007; aceptado con revisión el 6 de septiembre de 2007)


“Dado que el Neutralizer contiene minerales fuertemente paramagnéticos es de suponer un comportamiento de magnetoresistencia (efecto de Meissner) en presencia de campos electromagnéticos generados por teléfonos celulares. Así el escudo paramagnético, junto con el escudo ferromagnético del dispositivo es una explicación probable de la capacidad del Neutralizer de revertir los efectos indeseables de las emisiones de los teléfonos móviles sobre el ADN observados durante el estudio. Anteriormente propusimos la trasducción ferromagnética como la responsable de los efectos biológicos de los teléfonos móviles en razón de su resonancia con el mineral biológico magnetita. 1

La inversión de los efectos observados en el ADN en la serie I del presente estudio se corrobora igualmente por los resultados obtenidos al medir la intensidad de las emisiones del teléfono móvil mediante un


analizador de espectro (serie II). La tasa de absorción específica (SAR) se emplea de forma generalizada para medir la intensidad de las emisiones de los teléfonos móviles. Cuanto mayor sea el SAR mayor es el daño biológico que provocan.

Los resultados del presente estudio indican claramente que la intensidad de las emisiones de los teléfonos móviles se reduce en un 50% en presencia del Neutralizer. En todos los experimentos el Neutralizer resultó eficaz en todo el espectro de emisiones radio y microondas emitidos por este tipo de dispositivos.

I. Spectra at 94.5 MHz

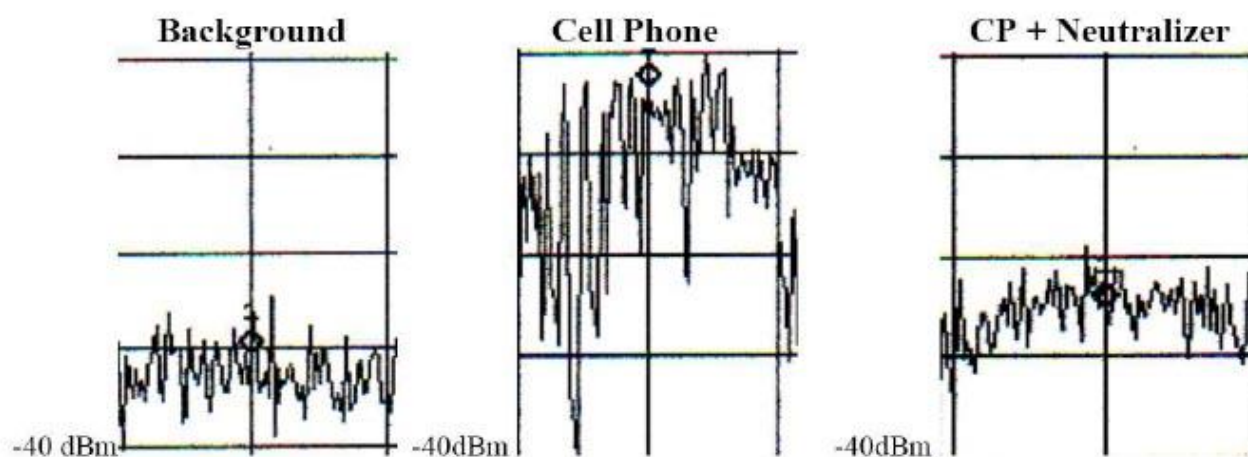

II. Spectra at 94.2 MHz

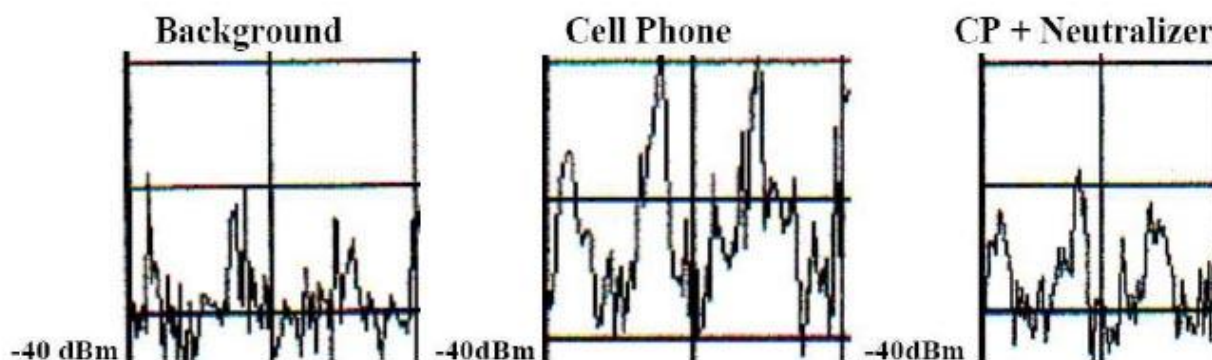

Tras comparar los datos del analizador de espectro con los datos del ADN podemos concluir que el Neutralizer es capaz de proteger el cuerpo de las radiaciones de los teléfonos móviles. Aunque el efecto bioprotector pudiera ser el resultado de la reducción de la intensidad de la emisión del teléfono celular, es igualmente posible que el campo electromagnético generado por el Neutralizer haya tenido un efecto estabilizador directo sobre el ADN.

En consecuencia, el Neutralizer ofrece una doble protección al cuerpo gracias a un doble mecanismo biológico y físico. Es el primer estudio que constata que un dispositivo de protección contra las radiaciones de los teléfonos móviles disponible en el mercado permite una acción dual.”

1. Cranfield, C., Wieser, H.G., Al Madan, J., Dobson, J., Preliminary evaluation of nanoscale biogenic magnetite-based ferromagnetic transduction mechanisms for wireless phone bioeffects. IEEE Transactions of Nanobioscience. Vol 2, pp. 40-43,2003.

Para saber más sobre las piedras paramagnéticas consultar la bibliografía de Phil Callahan.

Más información sobre los peligros de las radiaciones en: www.terapiaclark.es/radiaciones.htm

Mónica Gómez, terapeuta holística

Tlf: 902 996 375 - www.terapiaclark.es - pedidos@terapiaclark.es

Síguenos en **Twitter** @TerapiaClark